

## **Användarmanual Mobil uppresningslyft Sabina II**

### **Innan du kontaktar REHAB, kolla alltid att:**

- nödstoppen inte är intryckt.
- laddningssladden ej sitter i eluttaget.
- kablarna till kontrollboxen är rätt anslutna.
- batteriet är laddat.
- hjulen är rena från hår och smuts.

### **Användning**

Alla uppresningslyftar utprovas individuellt för varje brukare av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Uppresningslyft är ett hjälpmedel som skall användas när ingen annan aktiv förflyttningsteknik är möjlig. Med undantag vid akuta fall.

Vid användning av uppresningslyft krävs rätt lyft och rätt sele till varje brukare.

All personal som använder uppresningslyft skall ha fått instruktion om hur personen skall förflyttas och hur personlyften skall hanteras.

Två personal bör vara närvarande vid lyft. En vid lyften och en vid personen.

Förflyttningsavståndet med en uppresningslyft skall vara så kort som möjligt.

Följ anvisningarna på utprovningsprotokollet för hur selen/västen ska kopplas.

Kontakta rehab om brukaren upplever uppresningen smärtsam eller upplever obehag samt om personen inte klarar att sträcka på benen under uppresningen.

### **Skötsel**

Omvårdnadspersonalen ansvarar för att lyften rengörs och kontrolleras enligt bruksanvisningen. Detta skall göras vid behov dock minst en gång/månad.

Lyften ska ställas på underhållsladdning när den inte används.

Uppresningslyftar besiktigas via Dalarnas hjälpmedelscenter (DHC) 1 gång/år enligt avtal.


**Vid frågor eller om lyften är trasig kontakta arbetsterapeut el. sjukgymnast/fysioterapeut.**

**Se även tillverkarens bruksanvisning vid behov.**

## Planera förflyttningen och placering av uppresningslyften innan lyftet påbörjas.


### Uppresning av person vid aktivt lyft i Sabina uppresningslyft med Lyftbygel 350

För den här lyftbygeln rekommenderar vi Liko Uppresningsväst mod. 91 eller Liko Trygghetsväst mod. 93. När Lyftbygel 350 används har brukaren armarna utanför selen. Lyftbygel 350 i kombination med Trygghetsväst mod. 93 ger brukaren extra stöd i stående läge. Nedan finns en beskrivning av hur du använder Uppresningsväst mod. 91. Mer information finns i bruksanvisningen till respektive uppresningsväst.

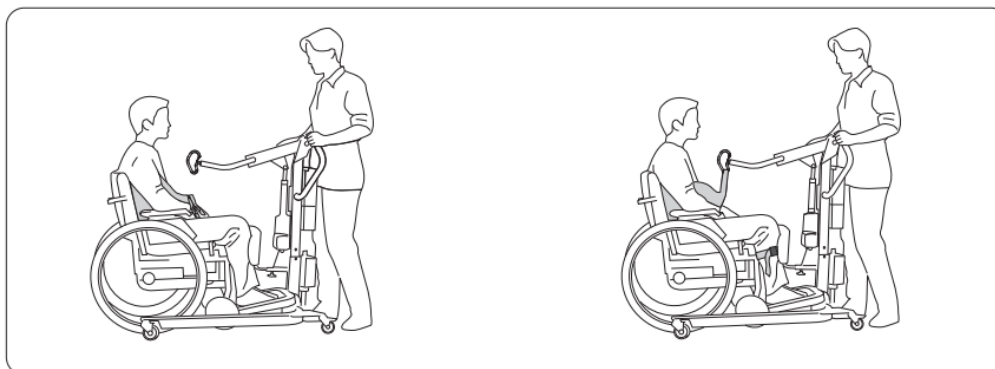

1. Placera Uppresningsväst runt brukaren enligt västens bruksanvisning. Placera Sabina uppresningslyft framför brukaren och justera bredden för underredet. Placera fötterna mitt på fotplattan med underbenen parallellt med underbensstödet. Justera höjden och djupet på underbensstödet efter behov för att ge bekvämt stöd under knäskålen.

2. Fäst västens band vid lyftbygeln's krokar.  
*Om tillämpligt: Dra åt vadbandet.*

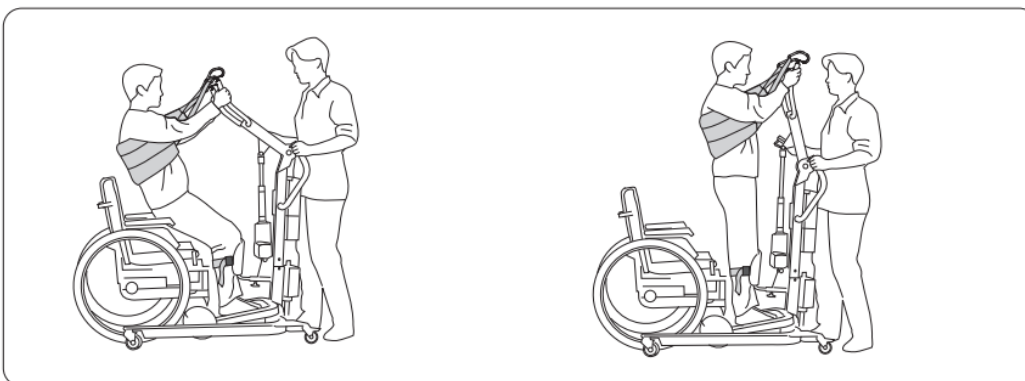


3. Lyft upp lyftbygeln ca 10–20 cm. Brukaren tar tag i lyftbygeln. Fortsätt med lyftproceduren. Om brukaren lutar sig bakåt blir det lättare att lyfta, vilket förhindrar att västen glider upp. Hur högt lyftet ska ske varierar från person till person.

**⚠ Innan brukaren lyfts från underlaget, men efter att västens band är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är korrekt påhakade på lyftbygeln.**

4. För att få ett mer upprätt läge fortsätter du lyft rörelsen till det översta läget. Lyft rörelsen kan upplevas som obehaglig för dem som inte är vana vid den. Observera att Sabina II EE uppresningslyft har två olika hastighetsinställningar. För maximal komfort bör lyftpelaren fästas vid underredet i det bästa av de tre fästhålen. Se sidan 10.


## Uppresning av person vid aktivt lyft i Sabina™ uppresningslyft med Comfortbygel

För den här lyftbygel rekommenderar vi Liko Comfortväst mod. 95. Den här kombinationen är lämplig för personer som är särskilt känsliga för tryck under armarna, till exempel personer som är förlamade på ena sidan av kroppen. Comfortvästen är utformad för att lyfta bakom ryggen och armarnas utsida. Comfortbygel kan även användas med Liko Trygghetsväst i begränsad omfattning. 93, särskilt för större brukare. Nedan följer en beskrivning av hur du använder Comfortväst mod. 95. Mer information finns i bruksanvisningen till respektive uppresningsväst.

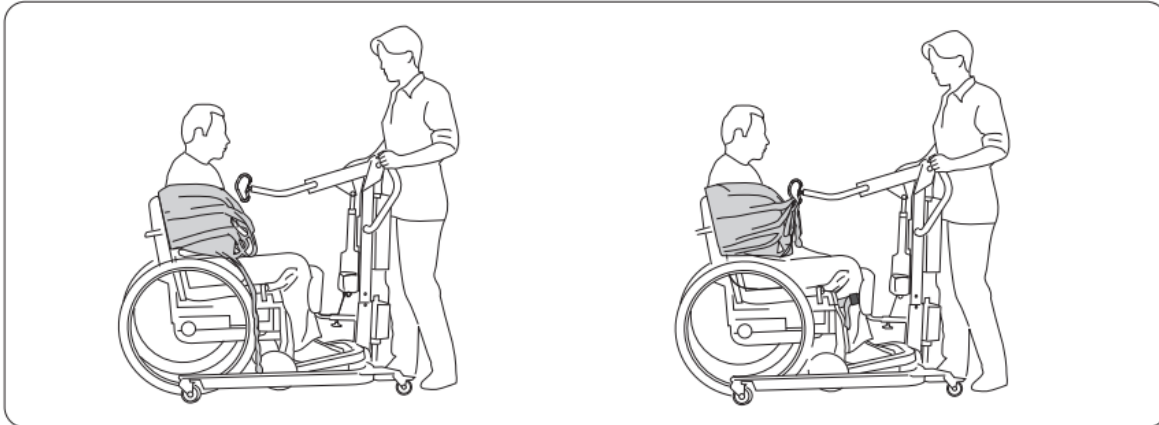

1. Placera Comfortväst runt brukaren enligt västens bruksanvisning. Placera Sabina uppresningslyft framför brukaren. Justera underredets bredd. Placera fötterna mitt på fotplattan med underbenen parallellt med underbensstödet. Justera höjden och djupet på underbensstödet efter behov för att ge bekvämt stöd under knäskålen.

2. Fäst västens band vid lyftbygelns krokar.  
*Om tillämpligt: Dra åt vadbandet.*

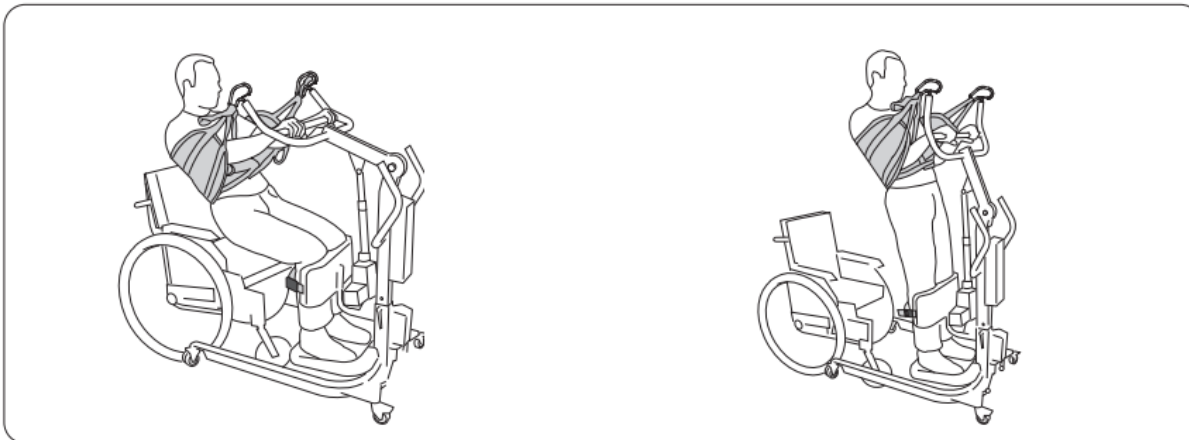

3. Lyft upp lyftbygel ca 10–20 cm. Brukaren tar tag i lyftbygel. Fortsätt med lyftproceduren. Om brukaren lutar sig bakåt blir det lättare att lyfta, vilket förhindrar att västen glider upp. Hur högt lyftet ska ske varierar från person till person.

**⚠ Innan brukaren lyfts från underlaget, men efter att västens band är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är korrekt påhakade på lyftbygel.**

4. För att få ett mer upprätt läge fortsätter du lyftrörelsen till det översta läget. Lyftrörelsen kan upplevas som obehaglig för dem som inte är vana vid den. Observera att Sabina II EE uppresningslyft har två olika hastighetsinställningar. För maximal komfort bör lyftpelaren fästas vid underredet i det bästa av de tre fästhål. Se sidan 10.